

[The page contains multiple lines of text that are almost entirely obscured by heavy black redaction bars. Only a few faint, illegible characters are visible through the gaps.]

吉野和洋製菓人

本规程主要起草人：

2 引用文献..... (1)

4 计量性能要求..... (1)

声强计校准技术规范

1 范围

本规程适用于频率 (0.8~50) kHz、加速度 (10~20000) m/s^2 范围内 声强计

校准和校准的声强计由本规程所规定 校准的声强计应符合 GB 10817 的要求

光电


光电

直流电源

考灵敏度的频率，比如2kHz。横向振动比不应超过10%。

各分检定项目能同时使用及校正

4.1 本检定规程适用于下列各型及规格的液体密度计

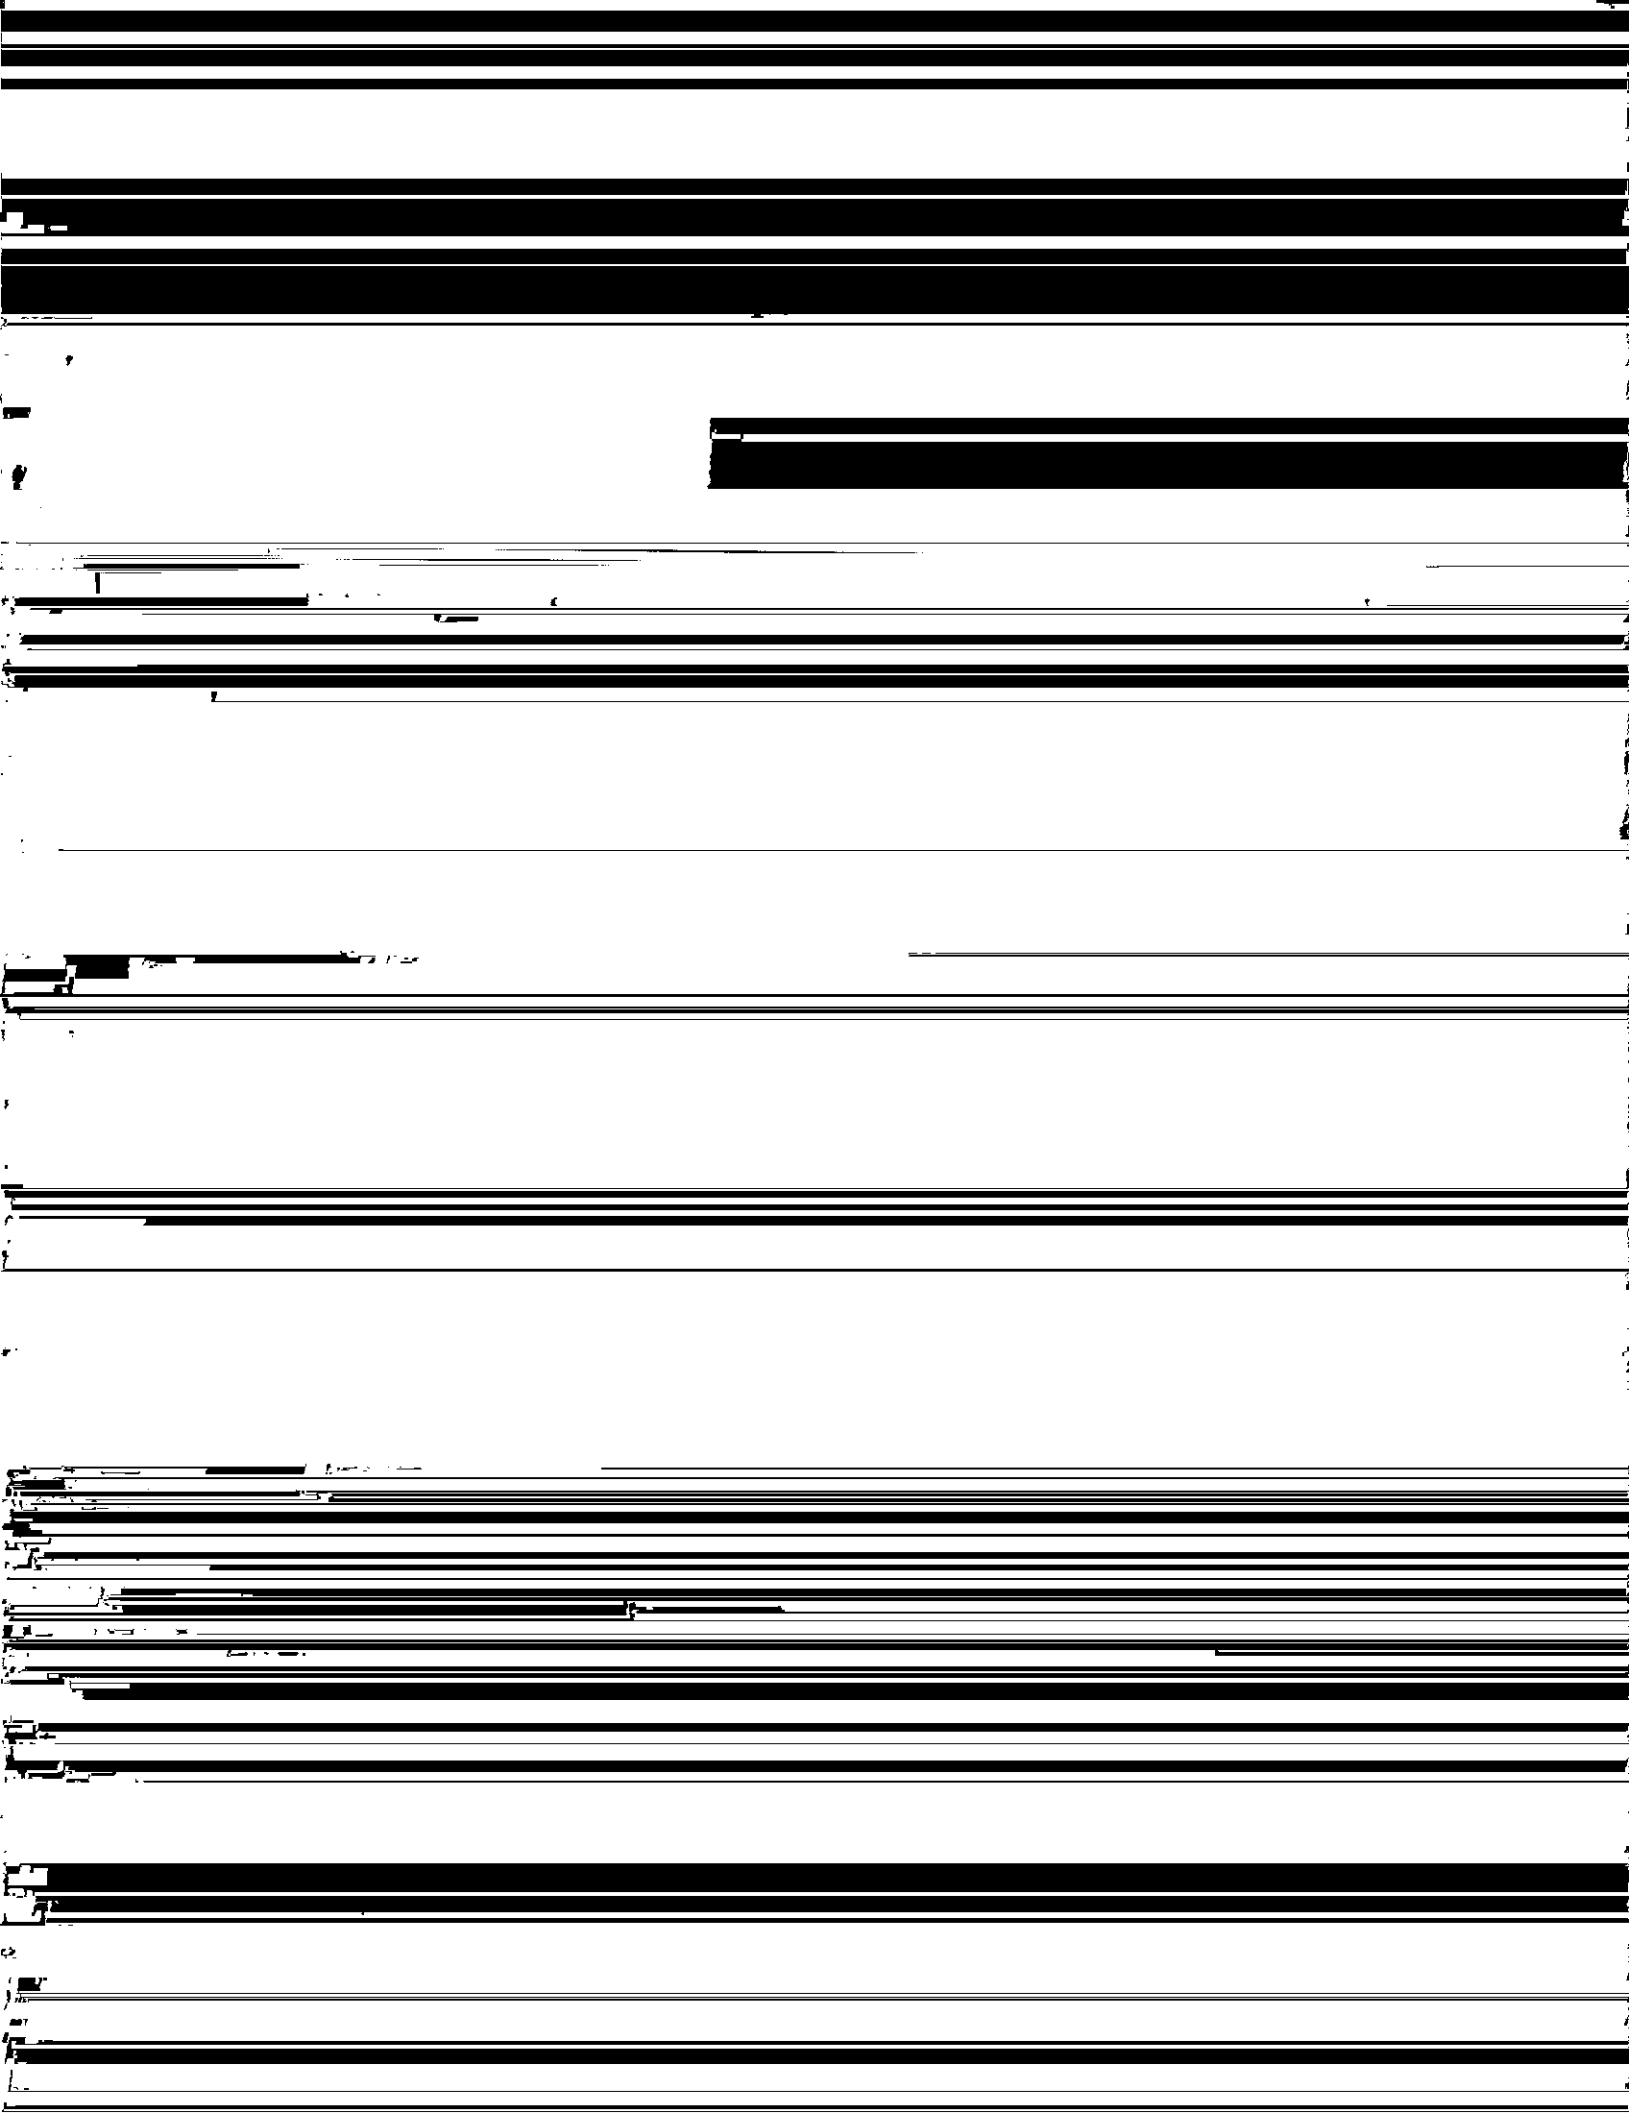

10 相邻两频率差值中的最大差值。

4. 测试频率占空比 根据生产厂家提供的高频台可以输出的加速度（或位

附录 A

2 顺安公姓十 (县十估)

附录 B

经检定共有 项不合格，不合格项目为：